

KARTA KATALOGOWA

Sita Ø 300 , h 30 mm z oczkami kwadratowymi firmy Haver & Boecker

Zgodno z Normami : EN 933-2 , ISO 3310 (cz 1 i 2)




Sita o średnicy 300 mm, obudowa ze stali nierdzewnej							
Nominalna wysokość sita 30 mm							
Wymiar oczka mm	Siatka tkana nierdzewna		Sita perforowane galwanizowane		Wymiar oczka mm	Siatka tkana nierdzewna	
	Nr kat.		Nr kat.			Nr kat.	
125,0			520449		0,900	520413	
112,0			520450		0,850	520415	
106,0			520451		0,800	520416	
100,0			520453		0,710	520417	
90,0			520454		0,630	520418	
80,0			520455		0,600	520419	
75,0			520456		0,560	520420	
71,0			520457		0,500	533639	
63,0			520458		0,450	520422	
56,0			520459		0,425	520423	
53,0			520460		0,400	520424	
50,0			520461		0,355	520425	
45,0			520462		0,315	520426	
40,0			520463		0,300	520427	
37,5			520464		0,280	520428	
35,5			520465		0,250	533622	
31,5			520466		0,224	520429	
28,0			520467		0,212	520430	
26,5			520468		0,200	520431	
25,0			520470		0,180	520432	
22,4			520471		0,160	520433	
20,0			520472		0,150	520434	
19,0			520473		0,140	520435	
18,0			520474		0,125	533614	
16,0			520475		0,112	520436	
14,0			520477		0,106	520437	
13,2			520478		0,100	520439	
12,5			520479		0,090	516723	
11,2			520480		0,080	520440	
10,0			520481		0,075	590317	
9,5			520482		0,071	520441	
9,0			520484		0,063	590587	
8,0			520485		0,056	520442	
7,1			520486		0,053	520443	
6,7			520487		0,050	520444	
6,3			520488		0,045	520446	
5,6	590665		520489		0,040	520447	
5,0	520395		520491		0,038	520448	

4,75	520396		520492		0,036		
4,5	520397		520493		0,032		
4,0	590324		590400		0,025		
3,55	520398				0,020		
3,35	520400						
3,15	520401						
2,8	520494						
2,5	520402						
2,36	520403						
2,24	520404						
2,0	590671						
1,8	520405						
1,7	520406						
1,6	520408						
1,4	520409						
1,25	520410						
1,18	520411						
1,12	520412						
1,0	533646						
			Akcesoria				
			Pokrywa sita		542463		
			Zbiornik dolny		542874		
			Dodatkowa górna uszczelka przyklejana		902751		
			Dodatkowa dolna uszczelka przyklejana		902744		
			Uszczelka PVC		540739		
			Uszczelka VITON (-15 ÷ +200 °C)		540622		
			Gumowa kulka Ø 20 mm		540443		
			Gumowa kostka 20x20x20 mm		902016		
			Certyfikaty				
			Certyfikat sprawdzenia		902367		
			Certyfikat kalibracji		902412		

Gwarancja : 12 miesi cy.

Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dokonuje nasza firma (od 50 lat obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych) .

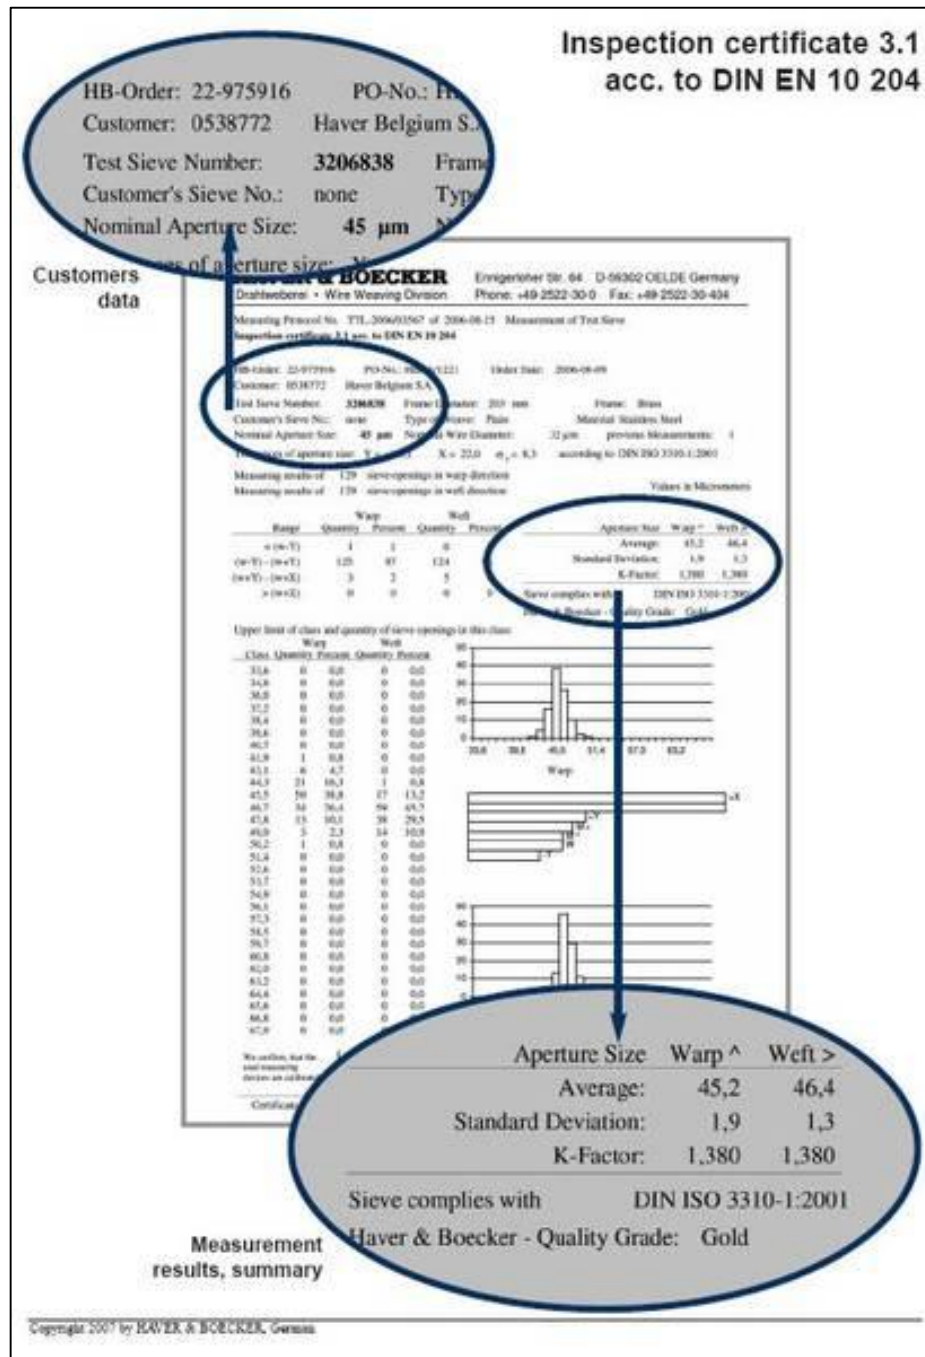

DIN EN 10 204		
Werksbescheinigung 2.1		
Certificate of Compliance with the Standard Attestation de conformité à la norme		
ANALYSENSIEB · TEST SIEVE · TAMIS DE CONTROLE		
DIN ISO 3310, ISO 565, ASTM E 11, BS 410, NF X 11-504		
Nennweite/Aperture width/Ouverture w: <u>0,30</u> mm		
Hergestellt unter Einhaltung der Vorgaben für die Qualitätssicherung nach ISO 9001. Das Analysensieb entspricht in seinen Toleranzen dem auf dem Typenschild genannten Standard. Manufactured in compliance with the quality assurance instructions according to ISO 9001. The test sieve tolerances coincide with the standard of the test sieve table. Notre fourniture est conforme aux prescriptions de l'assurance-qualité selon ISO 9001. Au point de vue tolérances, le tamis de contrôle correspond à la norme qui figure sur la plaque.		
HAYER & BOECKER DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK		
B 9 332 052002 10 Fe	HB-Fabrikationsnummer 4401185	Datum 14.11.02
		Werksachverständiger H.-J. Heck