

KARTA KATALOGOWA

Sita Ø 350 , h 60 mm z oczkami kwadratowymi firmy Haver & Boecker

Zgodno z Normami : EN 933-2 , ISO 3310 (cz 1 i 2)



Sita o średnicy 350 mm, obudowa ze stali nierdzewnej							
Nominalna wysokość sita 60 mm							
Siatka tkana nierdzewna			Sita perforowane galwanizowane		Siatka tkana nierdzewna		
Wymiar oczka mm	Nr kat.	Cena netto EUR	Nr kat.	Cena netto EUR	Wymiar oczka mm	Nr kat.	Cena netto EUR
125,0	521023	222,00	521133	216,00	0,900	521084	169,00
112,0	521024	222,00	521134	216,00	0,850	521085	169,00
106,0	521025	222,00	521135	216,00	0,800	521086	169,00
100,0	521026	222,00	521136	216,00	0,710	521087	169,00
90,0	521027	222,00	521137	216,00	0,630	521088	169,00
80,0	521028	222,00	521140	216,00	0,600	521089	169,00
75,0	521029	222,00	521141	216,00	0,560	521090	169,00
71,0	521030	222,00	521142	216,00	0,500	521091	169,00
63,0	521031	210,00	521143	216,00	0,450	521092	169,00
56,0	521032	210,00	521144	216,00	0,425	521093	169,00
53,0	521033	210,00	521147	216,00	0,400	521094	169,00
50,0	521034	210,00	521148	216,00	0,355	521095	169,00
45,0	521035	210,00	521149	216,00	0,315	521096	169,00
40,0	521036	210,00	521150	216,00	0,300	521097	169,00
37,5	521038	210,00	521151	216,00	0,280	521098	169,00
35,5	521039	210,00	521154	216,00	0,250	521100	169,00
31,5	521040	210,00	521155	216,00	0,224	521101	169,00
28,0	521041	210,00	521156	216,00	0,212	521102	169,00
26,5	521042	210,00	521157	216,00	0,200	521103	169,00
25,0	521043	210,00	521158	216,00	0,180	521104	169,00
22,4	521046	210,00	521159	216,00	0,160	521105	169,00
20,0	521047	189,00	521160	216,00	0,150	521106	169,00
19,0	521048	189,00	521161	216,00	0,140	521109	169,00
18,0	521049	189,00	521162	216,00	0,125	521110	169,00
16,0	521050	189,00	521163	216,00	0,112	521111	169,00
14,0	521052	189,00	521164	216,00	0,106	521112	169,00
13,2	521053	189,00	521165	216,00	0,100	521113	169,00
12,5	521054	189,00	521166	216,00	0,090	521116	169,00
11,2	521017	189,00	521167	216,00	0,080	521117	169,00
10,0	521055	189,00	521168	216,00	0,075	521118	169,00
9,5	521056	189,00	521171	216,00	0,071	521119	189,00
9,0	521057	189,00	521172	216,00	0,063	521120	201,00
8,0	521016	189,00	521173	216,00	0,056	521123	210,00
7,1	521058	189,00	521174	216,00	0,053	521124	213,00
6,7	521059	189,00	521175	216,00	0,050	521125	219,00
6,3	521060	189,00	521178	216,00	0,045	521126	249,00
5,6	521061	189,00	521179	216,00	0,040	521127	255,00

5,0	521015	189,00	521180	216,00	0,038	521128	316,00	
4,75	521062	189,00	521181	216,00	0,036	521129	330,00	
4,5	521063	189,00	521182	216,00	0,032	521130	384,00	
4,0	521064	189,00	521185	216,00	0,025	521131	582,00	
3,55	521065	189,00			0,020	521132	1 176,00	
3,35	521066	189,00						
3,15	521067	189,00						
2,8	521069	189,00						
2,5	521070	169,00						
2,36	521071	169,00						
2,24	521072	169,00						
2,0	521073	169,00						
1,8	521074	169,00						
1,7	521076	169,00						
1,6	521077	169,00						
1,4	521078	169,00						
1,25	521079	169,00						
1,18	521080	169,00	Akcesoria					
1,12	521081	169,00	Pokrywa sita		540261	168,00		
1,0	521083	169,00	Zbiornik dolny		540262	204,00		
			Zbiornik dolny do przesiewania na mokro		540305	300,00		
			Pier cie po redni		540266	102,00		
			Dodatkowa górna uszczelka przyklejana		902751	14,00		
			Dodatkowa dolna uszczelka przyklejana		902744	14,00		
			Uszczelka PVC		542906	2,50		
			Uszczelka VITON (-15 ÷ +200 °C)		540623	14,00		
			Gumowa kulka Ø 20 mm		540443	1,00		
			Gumowa kostka 20x20x20 mm		902016	1,00		
			Certyfikaty					
			Certyfikat sprawdzenia		902368	90,00		
			Certyfikat kalibracji		902413	268,00		

Podane ceny s cenami netto.


Ceny przeliczane s na PLN po kursie sprzeda y Banku PEKAO SA na dzie fakturowania.


Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

Cena obejmuje koszt obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesi cy.

Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dokonuje nasza firma (od 50 lat obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych) .

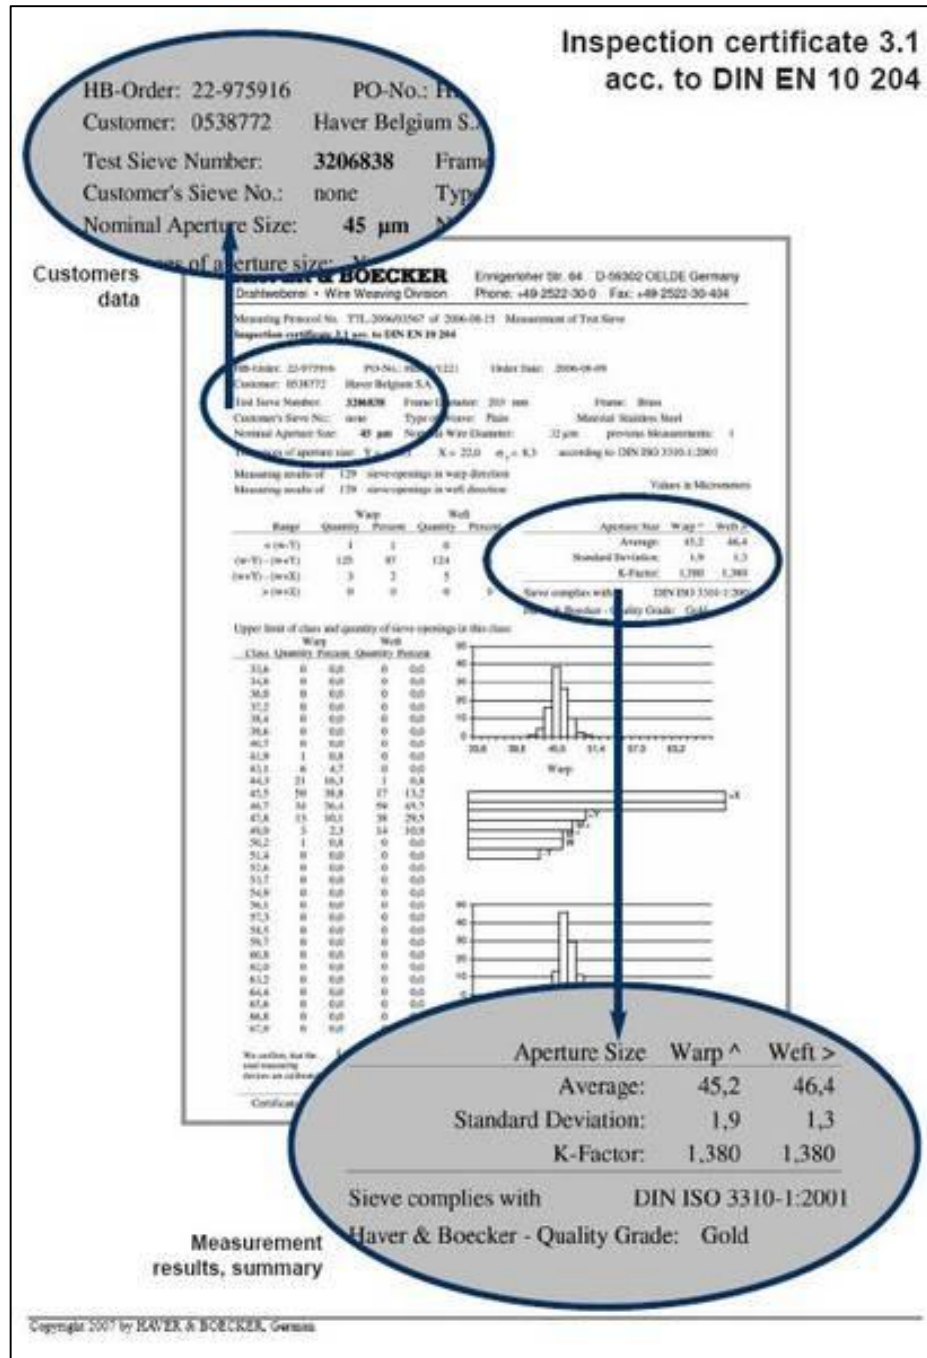

		
DIN EN 10 204 Werksbescheinigung 2.1 Certificate of Compliance with the Standard Attestation de conformité à la norme ANALYSENSIEB · TEST SIEVE · TAMIS DE CONTROLE		
DIN ISO 3310, ISO 565, ASTM E 11, BS 410, NF X 11-504		
Nennweite/Aperture width/Ouverture w: <u>0,30</u> mm		
<p>Hergestellt unter Einhaltung der Vorgaben für die Qualitätssicherung nach ISO 9001. Das Analysensieb entspricht in seinen Toleranzen dem auf dem Typenschild genannten Standard.</p> <p>Manufactured in compliance with the quality assurance instructions according to ISO 9001. The test sieve tolerances coincide with the standard of the test sieve label.</p> <p>Notre fourniture est conforme aux prescriptions de l'assurance-qualité selon ISO 9001. Au point de vue tolérances, le tamis de contrôle correspond à la norme qui figure sur la plaque.</p>		
H A V E R & B O E C K E R DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK		
B 9 332 052002 10 Fe	HB-Fabrikationsnummer 4401185	Datum 14.11.02
		Werksachverständiger H.-J. Heck
		